

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

23.06.2022

İstem No : 63006 : 22/2805
Talep Eden Birim : KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

- Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
 - 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
 - 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
 - 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
 - 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
 - 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
 - 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
 - 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
 - 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
 - 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.
 - 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
 - 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
 - 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 115 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARIMCISI

Tel :

Fax :

Mail :

28.06.2022

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399015	CONDOİT BİLEAFLET KALP KAPAĞI NO:23		1,0	ADET		
2	150030399016	CONDOİT BİLEAFLET KALP KAPAĞI NO:25		1,0	ADET		
3	15003039999575	CONDOİT KAPAK NO:27		1,0	ADET		
4	15003039999576	CONDOİT BİLEAFLET KALP KAPAĞI NO:21		1,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404
Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

CONDUIT BILEAFLET KALP KAPAĞI


TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalp kapakları Bileaflet yapıda olmalıdır. Kapak kafesi sağlam bir yapıda olmalı, extra güçlendirme halkasına ihtiyaç duyulmamalıdır
2. Kapak halkası titanium- vanadiumdan yapılmalı karbofilm ile kaplı olmalı ve tek bir parçadan yontularak inceltilmiş şekilde olmalıdır.
3. Kapakların sütür halkası carbofilm kaplı olmalıdır
4. Kapaklar sürtünmeyi minimum seviyeye indirmek ve optimum yıkamayı sağlamak amacıyla kanatçık pivotlarının menteşe mekanizmasına sürekli değişen ve bu noktadan teması sağlayacak yuvarlanabilir yapıda olmalıdır.
5. Pozisyonlama için sütür halkası dönebilir yapıda olmalıdır.
6. Kapak kanatçıkları, housing ve greft radyapak olmalı ve kanatçıkların açılma açısı 80 dereceden az olmalıdır.
7. Kapaklar maksimum hemodinamik performans, düşük basınç gradienti, en az kaçak akımın ve minimum türbulansı sağlamak amacıyla:
 - a) Curved kapakçıklı
 - b) Geniş kapak orifisi
 - c) Hidrodinamik housing airfoil profil yapısında olmalıdır
8. Kapakların :Mean Systolic Basınç Farkı, regurgitation ve enerji kayıpları düşük olmalıdır. Teklif veren firmalar bu konuyla ilgili çalışmalarını kliniğimize katalogları ile birlikte vereceklerdir.
9. Kapakların sütür halkası; doku gelişmesi (perivalvular sızıntı olasılığının minimize edilmesini) sağlamak amacıyla kanla temas etmeyen yerler double velour dacron olmalıdır. Kanla temas eden yerler ise carbofilm kaplı teflon fabrik olmalıdır.
10. Kapak, hastaların manyetik rezonans incelemelerine engel oluşturmamalıdır. (MR kompetible olmalıdır).
11. Kapağa kompozit greft, carbofilm ve kolajen kaplı double velour woven fabrik olmalıdır.
12. Kapakların efektif orifis alanı yüksek olmalı ve düşük profilli yapısı olmalıdır. Teklif veren firmalar bu bilgileri kliniğimize vereceklerdir.
13. Kapağa kompozit greft, sıfır poroziteye sahip olmalıdır ve preclotting işlemi yapılmasına gerek duyulmamalıdır. Greftin uzunluğu 12cm den az olmamalıdır.
14. Kalp kapağı için 21,23,25,27 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
15. Kapak steril kutuda ve tutucusu önceden monte edilmiş şekilde olmalıdır. Kapaklar ile aynı kutuda tek kullanımlık steril rotator ve steril koter bulunmalıdır.

Verilecek Dökümanlar;

1. Kapaklar hakkında ayrıntılı bilgi içeren kataloglar
2. Teknik şartname maddelerine uygun olduğunu gösterir tek tek cevaplandırılmış uygunluk belgesi
3. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler ihale dışı bırakılacaktır

Dr. Öğrt. Üyesi Latif ÜSTÜNEL
Kalp ve Damar Cerrahisi
Öğretim Üyesi

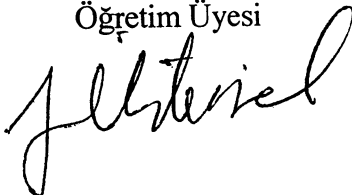

Prof. Dr. Oktay BURMA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı

