

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

05.06.2023

İstem No : 69746 : 23/2468
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14.00
09.06.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	25502020108002	MFP YAZICI		5,0	ADET		
2	25502020108003	SFP YAZICI		15,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ŞARTNAME NO
2518

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 31.05.2023

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİLGİSAYAR TEKNİK KOMİSYONU
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kullanılan HBYS kapsamında merkezi kullanılmak üzere, aşağıda özellikleri belirtilen cihazlar alınacaktır. Bu malzemelerin alımında dikkat edilecek teknik özellik ve diğer hususlar aşağıda listelenmiştir;

1. GENEL ÖZELLİKLER;

- 1.1. Teklif edilen tüm ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- 1.2. Teklif edilecek tüm donanımlar için gerekli olan güç kablosu, gerekli olabilecek (Güç, IDE, SATA, dönüştürücü, USB vb gibi) diğer tüm kablolar, kullanıcı kılavuzları, sürücü CD (ve diğer yardımcı programlar) veya disketleri her bir cihaz ile birlikte verilecektir.
- 1.3. Teklif edilen tüm ürünler, açılmamış ambalajlarında, orijinal kuruluş disketleri veya CD-ROM'ları ile kullanım kılavuzları ve varsa garanti belgeleri eksiksiz ve her bir parça için ayrı olarak verilecektir.
- 1.4. Teklif edilen parça konfigürasyonlarındaki değişikliklerde üniversitemiz lehine olan durumlar dikkate alınacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde nihai karar ihale komisyonuna aittir.
- 1.5. Teknik şartnamede belirtilmeyen ancak sistemin çalışması için gerekli olan parçalar firmalar tarafından önerilecek ve firmalar bu durumu tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
- 1.6. Şartnamede belirtilen koşullar arasında herhangi bir ihtilafın olması halinde Fırat Üniversitesi Hastanesi kendisine en uygun olan maddeye göre talepte bulunur. İlgili firma(lar) aynı konuda diğer maddeler üzerinde hak talebinde bulunamaz.
- 1.7. Teklif veren firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni ürün ve cihazları vermekle yükümlüdür. İhale başlangıcından ürünlerin teslimine kadar geçen süreçler ve hızlı teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak, teklif edilen ürünlerin piyasa koşullarında temininin güçleşmesi veya olanaksızlaşması durumunda, firma bu ürünün piyasada bulunan teknolojik açıdan daha üstün ve yeni bir marka ve/veya modelini vermekle yükümlüdür. Bu hususta Fırat Üniversitesi Hastanesi, söz konusu ürün(leri) isteme, kabul veya red etme haklarını saklı tutar.
- 1.8. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, kesin kanının oluşmadığı durumlarda, gerekli gördüğü takdirde firmalardan, teklif ettikleri ürünlere dair, numune, yazılı açıklamalar veya belgeler isteyebilir. Tanınan süre içinde istenilen belge, doküman veya örnek malzemeleri getirmeyen firma(lar) değerlendirme dışı bırakılır.

2. MFP YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 2.1. Cihazı A4 Siyah/Beyaz Çok işlevli olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ergün ÇAKMAK
Bilgisayar Teknikeri
Bim Depo Sorumlusu

ONAYLAYAN

Yrd. Doc.Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemi ve Kalite
Koordinatörü

ŞARTNAME NO

2518

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 31.05.2023

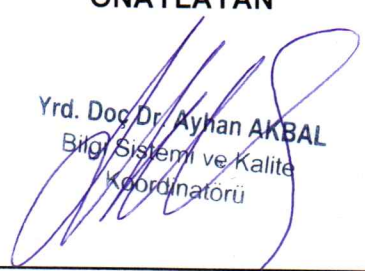
- 2.2. Cihazın baskı hızı A4 için en az 40 ppm olacaktır.
- 2.3. İlk Baskı Hızı 6,3 saniye veya daha az olmalıdır.
- 2.4. Cihazın üzerinde 2,7 inç renkli dokunmatik ekran olmalıdır.
- 2.5. Cihazın aylık baskı kapasitesi en az 80.000 sayfa olmalıdır.
- 2.6. Cihazın İşlemci Hızı en az 1200MHz olmalıdır.
- 2.7. Cihaz belleği en az 512 MB olmalıdır.
- 2.8. Cihazın çift yüzlü baskı ünitesi olmalıdır.
- 2.9. Cihazın en az 2 adet kağıt yükleme tepsi olmalıdır.
- 2.10. Cihazın Tarama Çözünürlüğü en az 1200dpi olmalıdır.
- 2.11. Cihazın Tarama Hızı en fazla 20 saniye/sayfa renkli ve 29 saniye/sayfa siyah/beyaz olmalıdır.
- 2.12. Cihazın Doküman Girişi 50 sayfalık RADF (Otomatik Kağıt Çevirici), düz yataklı tarayıcı olmalıdır.
- 2.13. Cihaz çift taraflı otomatik tarama özelliği olmalıdır.
- 2.14. Cihaz S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High comprssion PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility) formatları desteklemelidir.
- 2.15. Cihazın İlk Kopyalama Süresi en fazla 10 saniye olmalıdır.
- 2.16. Cihazın Kopyalama Hızı en az 40 cpm olmalıdır.
- 2.17. Cihaz üzerinden Küçültme/Büyütme, %25-400 yakınlaştırma işlemlerini desteklemelidir.
- 2.18. Cihaz 1adet Hi-Speed USB 2.0; 1 adet arka ana bilgisayar USB; 1 adet ön USB bağlantı noktası; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T ağı; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi + BLE bağlantılarını desteklemelidir.
- 2.19. Cihaz 802.1X ile kimlik doğrulama yapabilmelidir.
- 2.20. Cihaz Yazıcı dili PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS desteklemelidir.
- 2.21. Cihaz Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
- 2.22. Cihaz Kağıt Kapasitesi 1. Çekmece: 80gr/m2?lik en az 150 sayfa; Çok amaçlı çekmece: 80gr/m2?lik en az 100 sayfa desteklemelidir.
- 2.23. Cihaz A4, A5, B5, A6, Zarflar (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Özel Boyut (afişler dahil 1321mm uzunluğa kadar), 4 x 6?, 5 x 7? kağıt tiplerini desteklemelidir.
- 2.24. Cihaz 60 - 200 gr/m2 kalınlıktaki kağıtları desteklemelidir.
- 2.25. Cihaz Çift Taraflı Baskı yapabilmelidir.
- 2.26. Cihaz 230 VAC +/- %10, 50~ 60Hz +/- %2 gerilim değerlerinde çalışabilmelidir.
- 2.27. Cihazın maksimum güç tüketimi 510 watt olmalıdır.
- 2.28. Cihazın : CISPR 32:2015 Sınıf B / EN 55032:2015 Sınıf B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Sınıf B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Kısım sertifikalarını sağlamalıdır.
- 2.29. Cihazın Tarayıcı tipi Masaüstü, OBB; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Ön panelden tarama, kopyalama, e-posta ve dosya düğmeleri; Scan yazılımı; ve TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması; İkili sürüm: Sürüm 2.3; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi'ye kadar yapabilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversite Hastanesi
Ergün ÇAKMAK
Bilgisayar Teknikeri
Bim Depo Sorumlusu

ONAYLAYAN

Yrd. Doç Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemi ve Kalite
Koordinatörü

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ŞARTNAME NO 2518	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 31.05.2023
2.30. Cihazın aylık tarama kapasitesi en az 750 ? 4000 olmalıdır. 2.31. Cihazın Garanti süresi en az 3 yıl olacaktır. 2.32. Cihaz ile birlikte cihaza takılı toner dışında bir tane tam dolu yedek toner verilecektir. 2.33. Cihaz ile birlikte takılı toner haricinde 1 adet yedek tam dolu toner verilecektir. 2.34. Garanti süresi içinde arızalanan parçalar, en geç 10 iş günü içinde tamir edilecektir. Tamir süresince yerine kullanılmak üzere satıcı firma tarafından yenisi verilmelidir. 2.35. Teslim süresi teklifte mutlaka belirtilecektir. 3. SFP YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3.1. Cihazı A4 Siyah/Beyaz işlevli olacaktır. 3.2. Cihazın baskı hızı A4 için en az 40 ppm olacaktır. 3.3. İlk Baskı Hızı 6,1 saniye veya daha az olmalıdır. 3.4. Cihazın üzerinde 2 satır LCD ekranı olmalıdır. 3.5. Cihazın aylık çalışma döngüsü en az 80.000 sayfa olmalıdır. 3.6. Cihazın İşlemci Hızı en az 1200MHz olmalıdır. 3.7. Cihaz belleği en az 256 MB olmalıdır. 3.8. Cihazın çift yüzlü baskı ünitesi olmalıdır. 3.9. Cihazın en az 2 adet kağıt yükleme tepsisi olmalıdır. 3.10. Cihazın baskı çözünürlüğü en az 1200x1200 dpi olmalıdır. 3.11. Cihazın Tarama Hızı en fazla 20 saniye/sayfa renkli ve 29 saniye/sayfa siyah/beyaz olmalıdır. 3.12. Cihaz 1 Hi-Speed USB 2.0; arka tarafta 1 ana bilgisayar USB; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağı; 802.3az (EEE) bağlantıları desteklemelidir. 3.13. Cihaz 802.1X ile kimlik doğrulama yapabilmelidir. 3.14. Cihazın 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1, 250 yapraklık giriş Tepsisi 2 olmalıdır. 3.15. Cihaz IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 sertifikalarını desteklemelidir. 3.16. Cihaz Harici arka USB bağlantı noktası yoluyla isteğe bağlı iş depolama özelliği olmalıdır. 3.17. Cihazın Garanti süresi en az 3 yıl olacaktır. 3.18. Cihaz ile birlikte cihaza takılı toner dışında bir tane tam dolu yedek toner verilecektir. 3.19. Cihaz ile birlikte takılı toner haricinde 1 adet yedek tam dolu toner verilecektir. 3.20. Garanti süresi içinde arızalanan parçalar, en geç 10 iş günü içinde tamir edilecektir. Tamir süresince yerine kullanılmak üzere satıcı firma tarafından yenisi verilmelidir. 3.21. Teslim süresi teklifte mutlaka belirtilecektir.		
HAZIRLAYANLAR  Fırat Üniversitesi Hastanesi Ergün ÇAKMAK Bilgisayar Teknikeri Bim Depo Sorumlusu		ONAYLAYAN  Yrd. Doç. Dr. Ayhan AKBAL Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörü
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		
		Sayfa 3