

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.01.2022

İstem No : 59952 : 22/300
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
02.02.2022

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15012020299008	HIZLI YAPIŞTIRICI 401 LOCTİTE 20 GR		3,0	ADET		
2	15012020299009	HIZLI YAPIŞTIRICI 406 FOCTİTE 20 GR		3,0	ADET		
3	15012020299010	HIZLI YAPIŞTIRICI 495 LOCTİTE 20 GR		3,0	ADET		
4	15013021944	ROTKON HASTABAŞI PLASTİK KUMANDA TUTAMAĞI		30,0	ADET		
5	15013021946	TRANSFER SEDYESİ KAYAR TABLA TEKER TAKIMI		25,0	ADET		
6	15013021947	NİTROKARE NTCR SD 05 SEYE 5.TEKER PİSTONU		4,0	ADET		
7	15013021948	MAGAMAT MCZ 51996 MOTOR		3,0	ADET		
8	15013021949	TAUTMAN HASTABAŞI YATAK GÖVDE KALDIRMA MİLİ VE TEKERİ		20,0	ADET		

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

9	15013021950	TAUTMAN HASTABAŞI YATAK TIMOTION KONTROL KUTUSU	2,0	ADET
10	15013021951	TAUTMAN HASTABAŞI YATAK TIMOTION HEMŞİRE KUMANDASI	4,0	ADET
11	15013021952	TAUTMAN HASTABAŞI YATAK SEYYAR KUMANDASI	4,0	ADET
12	15013021954	TAUTMAN YATAK YUKARI KALDIRMA MEKANİZMASI MİLİ	30,0	ADET
13	15013021956	4.0X10 AVRUPATIP POP PERÇİN	1.000,0	ADET
14	1501208050	QA3 HASTA SEDYE 5.TEKERİ	20,0	ADET
15	1501208059	PJP 125X32 FRENLİ TEKER	15,0	ADET
16	1501302083	RÖLE 24 VOLT DC- 16A 250 VOLT	20,0	ADET
17	15013021857	12 VOLT 7 AH YUASA BATARYA	6,0	ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR


Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 2



4

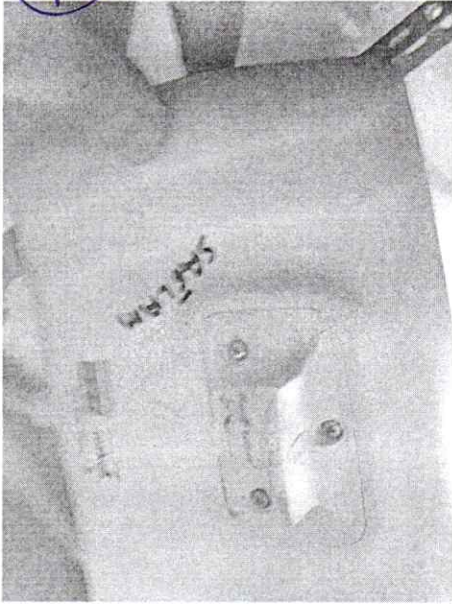

14





8

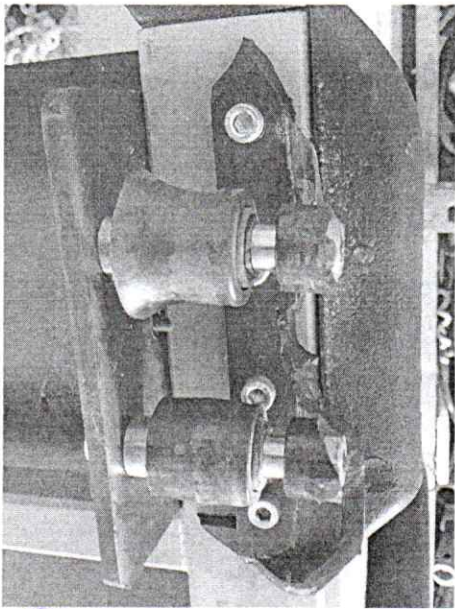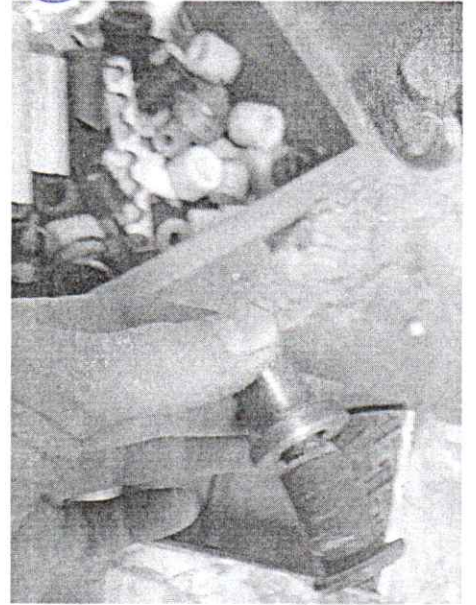

5

10

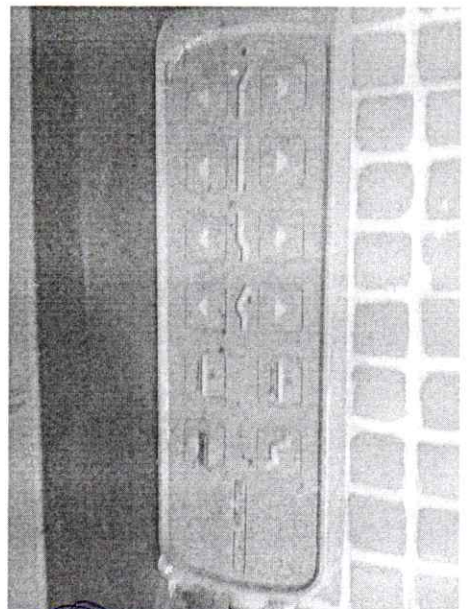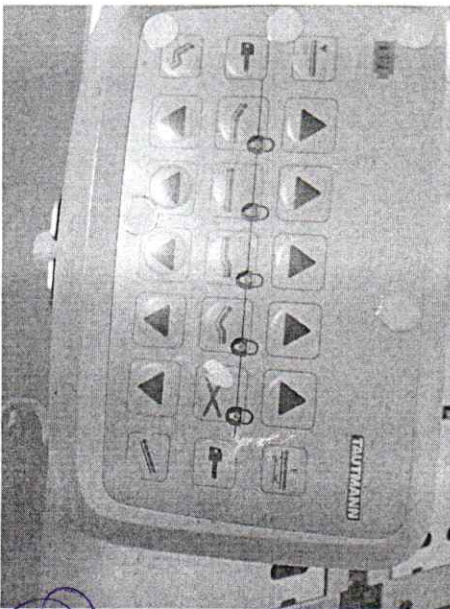

11

Fikret GEDİK
Teknisyen

Talet CEMALAN
Istanbul University Hospital
Hospital Director

TEKNİK ŞARTNAME

1,2 VE 3 NOLU İSTEKLER 20 GRAMLIK KUTULARDA OLMALIDIR.

4 nolu istek kumandanın arkasındaki plastik parçadır.

5 nolu istekteki malzeme rausmann/tauttman marka ameliyathane transfer sedyesinde ki plastikten yapılan ortasında rulman olan parçadır.

6 nolu istekteki parça 15 cm boyundadır.

7 nolu parça okin marka 24 volt motordur.

8 nolu parça yatağın kaldırma ekleminde kullanılacaktır.Fotografda numunesi vardır.

9 nolu parça 24 voltta çalışan röle kontrol ünitesidir.

10 nolu parça yatak başında buluna kablolu yatağı kontrol kumandasıdır.

11 nolu parça kablolu seyyar kumandadır.

13 nolu parça aliminyum perçindir.

14 nolu parça 75mm çapında 2 rulmanlı tekerdir.

15 nolu parça ortadan montajlı 125 mm çapında tente tekerdir.

16 nolu parça 24 volt 5 bacaklı finder röledir.

17 nolu parça wölker yataklarda kullanılacak 12 volt 7 amper kuru tip aküdür.

Fikret GEDİK
Teknisyen

TALAT CEYLAN
Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü